

一般社団法人 医療安全全国共同行動 設立記念シンポジウム

歯科診療所における医療安全

2013年6月16日


公益社団法人 日本歯科医師会医療安全対策委員会
診療所部会WG 松尾 亮

歯科診療所はどういう所？

- ムシ歯の治療をします。
(金属の被せ、詰め物など)
- 入れ歯を作ります。
- 歯周病の治療をします。
(除石など)
- 抜歯などの外科的観血処置も
します。(インプラント治療)
- その他



平成21年度厚生労働科学研究費補助金
 「歯科医療における安全管理評価法の確立に関する研究」
 我が国の歯科診療所におけるインシデント実態調査より


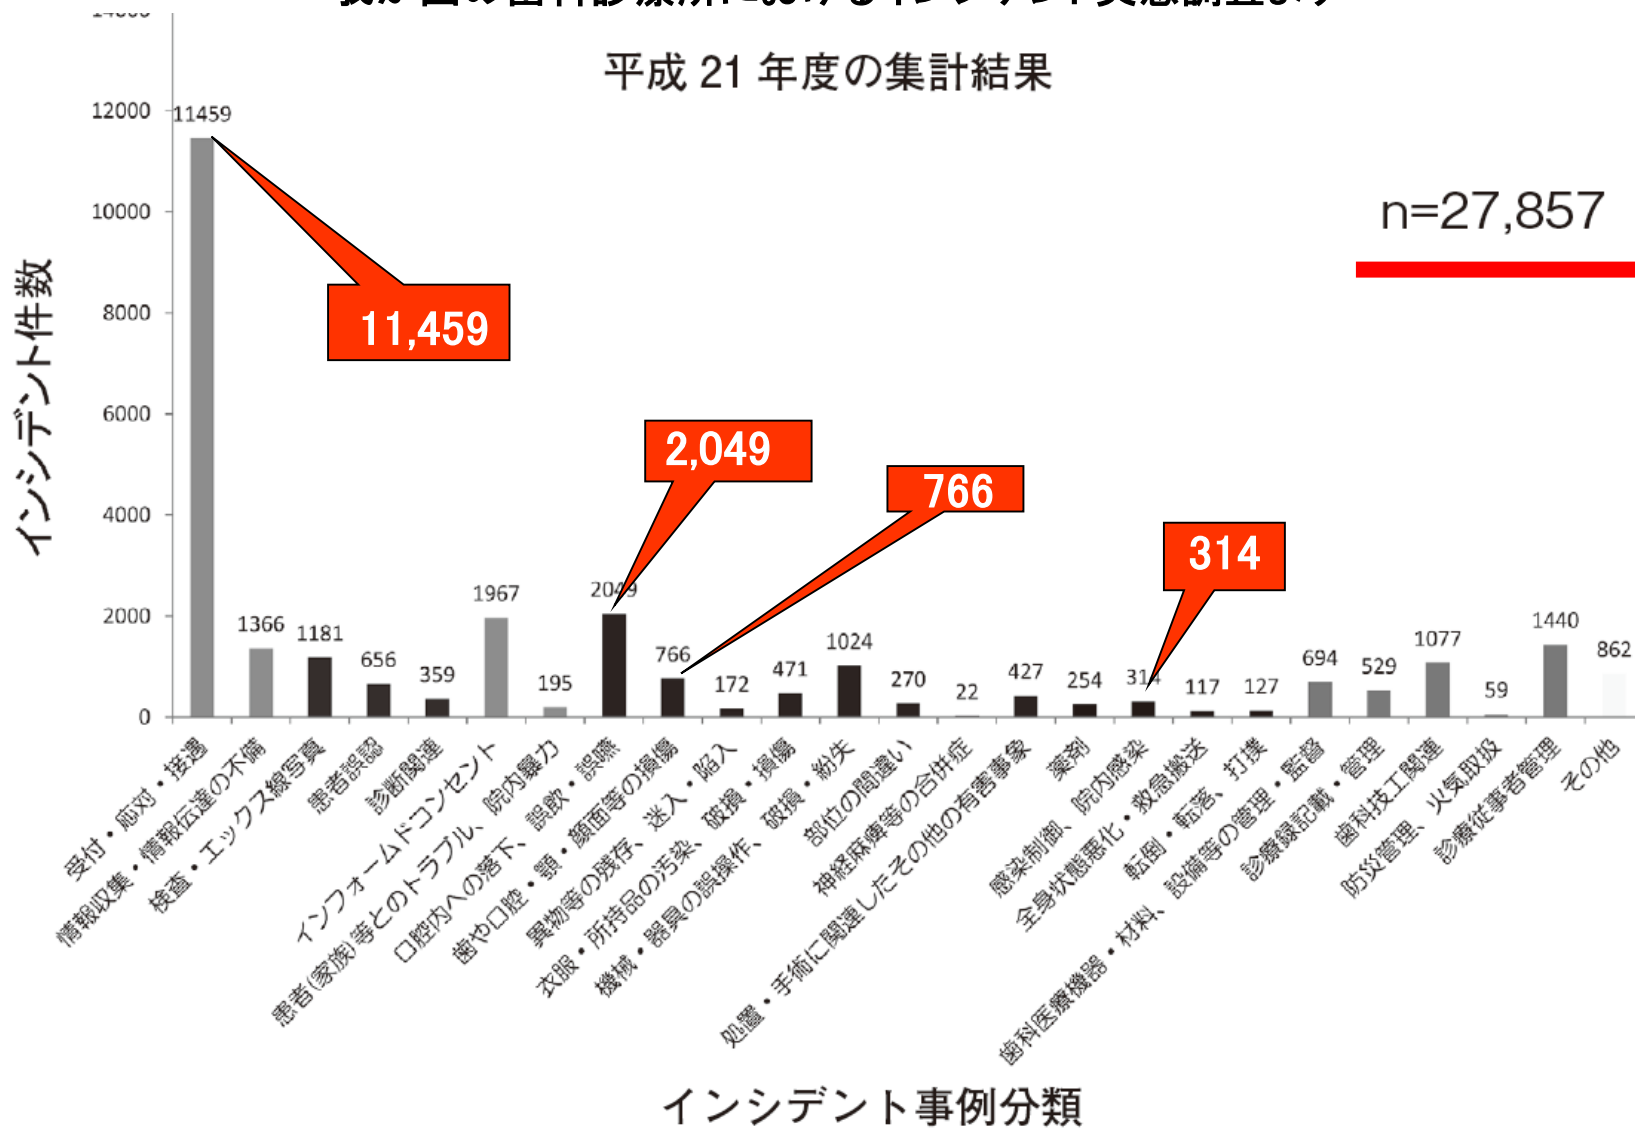


宮本智行：我が国の歯科医療における良質かつ安全な医療の推進を目指して。
 医療の質・安全学会誌. 第7巻3号. P.246-251. 2012.

歯科診療所



転倒

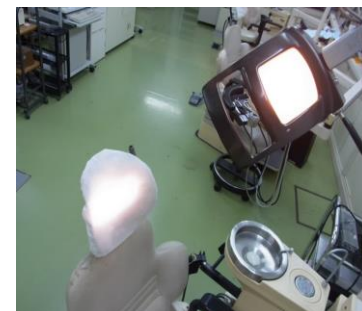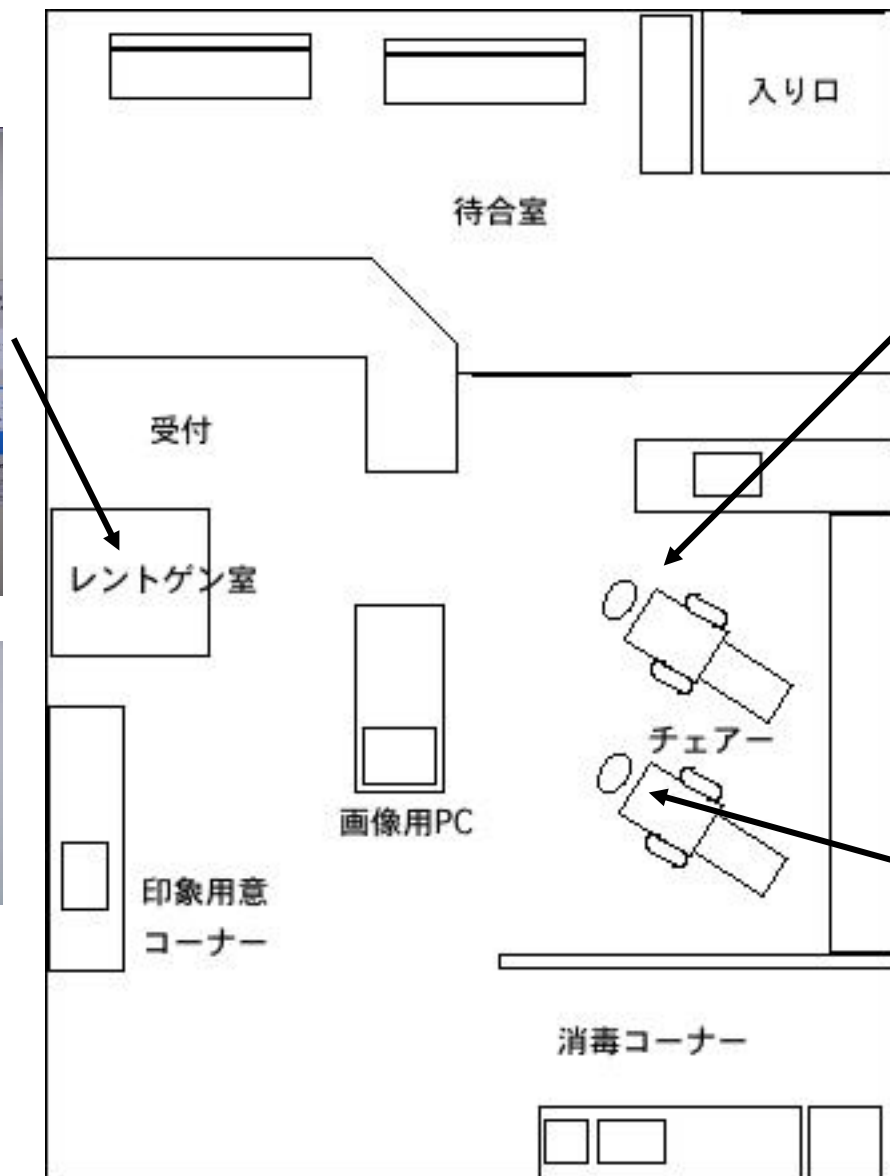

ライトに頭をぶつけた



誤嚥

歯科診療所

医療廃棄物の分別方法

感染性廃棄物
 ● 鋭利なもの (未使用も含む)
 ● 血液・体液が付着した、もしくは付着した跡のある全てのもの



鋭利物類
 ● 感染症患者に使用したもの
 ● 検査等に用いたもの

プラスチック類
 ● 血液・体液が付着していない
 ● プラスチック製
 ● 針、注射器の筒、金庫、ガラス類は薬液
 ● 点滴(リック・ポリ)容器の中身は空にする


ビン類
 ● 中身の液体等は空にする

アンブル類・石膏
 ● 石膏くず

感染性廃棄物など

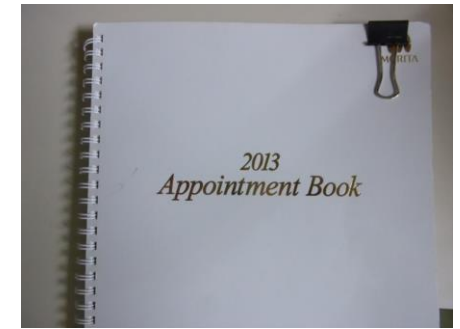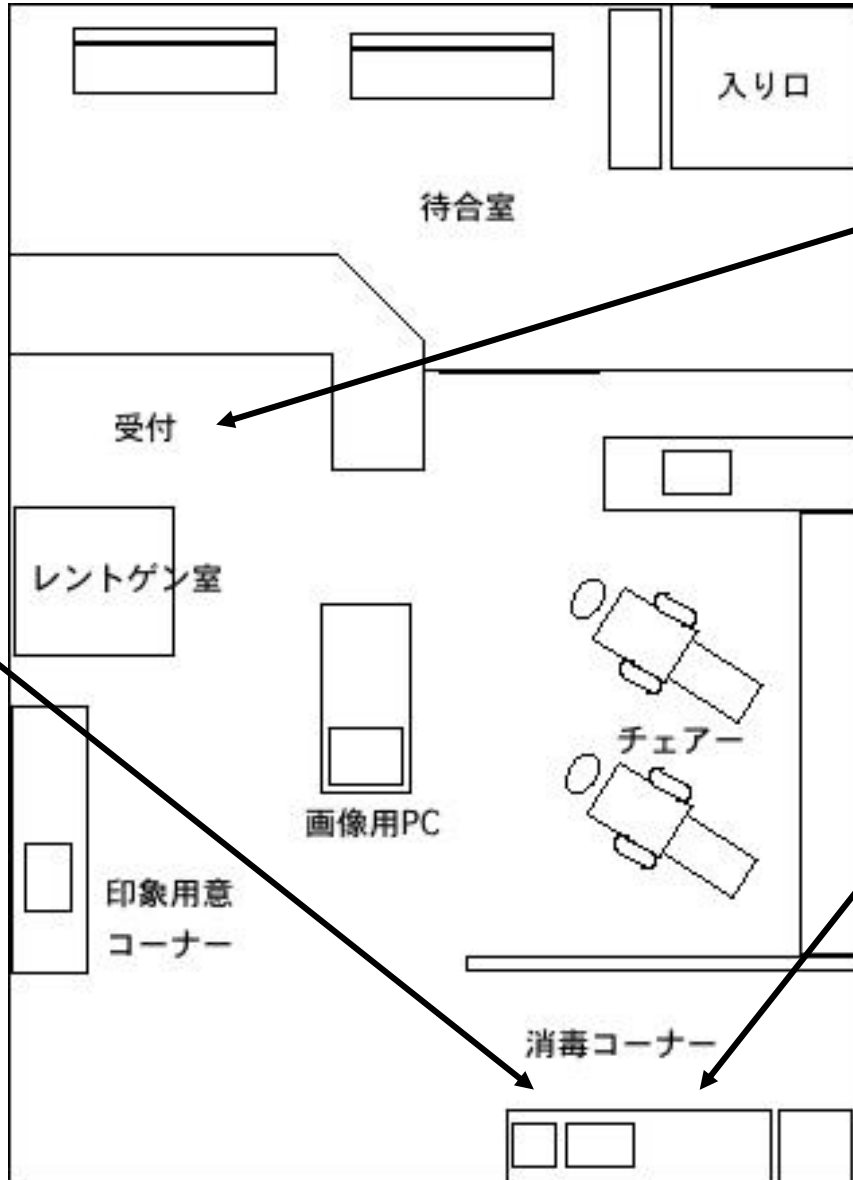


アポイント間違い
 投薬間違いなど

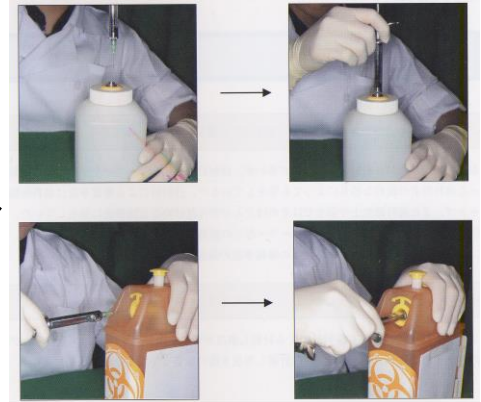

針刺し

医療安全管理マニュアル

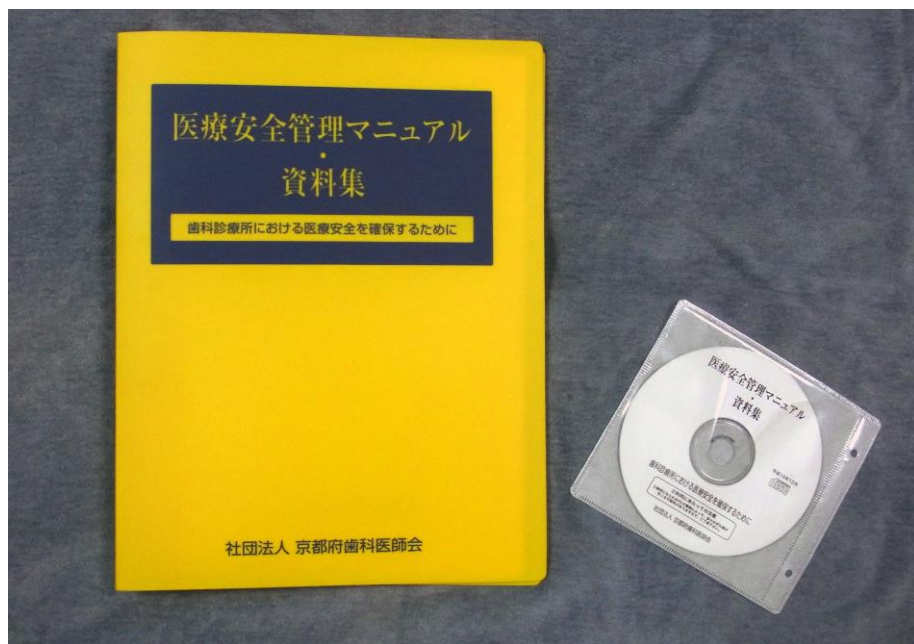

備えあれば・・・



救急セットのお申込みをいただきありがとうございました。
セット内容は下記の通りです。

能書・使用期限等ご注意くださいようお願いいたします。

救急薬セット

品名	定数	使用期限	製造番号
メイロン静注7%	2A	2013.07	M1G70
デカドロン注射液1.65mg	2A	2014.05	8FN26P
ニトロベン舌下錠0.3mg	3T	2014.07	712340
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	2tウ	2014.05	110628PA
ホリゾン注射液10mg	2A	2015.01	E012G01
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	2tウ	2014.07	110808PA
エホチール注10mg	2A	2014.08	190007
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2tウ	2014.06	110719VA
大塚生食注 100mL	2B	2015.10	1J96P

※スタドール注1mgは製造中止のため含まれておりません。

ニプロ輸液セット ISA-200A21Z	2本	2014.08	11114A
ニプロ ショートシリンジ針付 1mL 23G	5本	2014.01	11B10F
ニプロ シリンジ 針なし 20mL	3本	2014.08	11106
ニプロ ディスポ針 22G1・1/4SB	5本	2016.06	11G181

「病-診」 「医科-歯科」連携

